Aniosyme DD1

Aniosyme DD1 est recommandé pour nettoyer et pré-désinfecter l'instrumentation médico-chirurgicale, les dispositifs médicaux et le matériel d'endoscopie. Indispensable avant toute phase de stérilisation de vos instruments, pour en éliminer les souillures organiques et minérales. Aniosyme DD1 permet de vous protéger ainsi que vos patients des risques de contamination.

CE 0459

PROTOCOLE D'UTILISATION

AVANT DE COMMENCER

Mettre des gants appropriés.

MODE D'EMPLOI

Dilution à 0,5 %.
Temps de trempage :
5 minutes minimum.
Nettoyage en cuve
à ultrasons.

ATTENTION

- Renouveler le bain de nettoyage après chaque utilisation.
  Circulaire n° 138 du 14 mars 2001.
- Produit d'usage externe. Ne pas avaler.
- Précautions d'emploi : se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette. Produit classé selon la Directive Européenne "Préparations dangereuses" 1999/45/CE.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

- **Bactéricide** (NF EN 1040, NF T 72-171, pr en 13727).
- **Actif sur BK.**
- **Fongicide** (NF EN 1275).
- **Actif sur HIV-1, sur le virus de l'Hépatite B et BVDV (virus modèle de l'Hépatite C).**

1 Dosez 5 ml d'Aniosyme DD1 par litre d'eau.

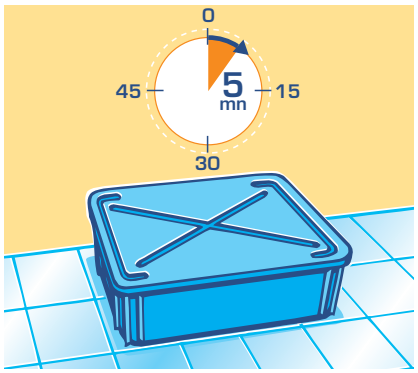

2 Immergez totalement les instruments. Le temps de trempage minimum pour une efficacité microbiologique (bactéries, levures, moisissures et virus) est de 5 minutes minimum.

3 Brossez si nécessaire afin d'éliminer toutes les souillures visibles.

4 Rincez soigneusement sous eau courante.

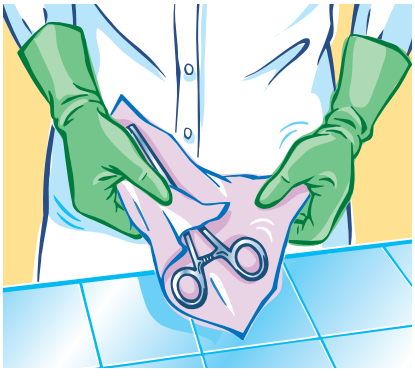

5 Essuyez avec un champ propre.

RECOMMANDATION : protocole à renouveler une seconde fois.

Fisher Bioblock Scientific
Parc d'innovation - BP 50111 - F67403 illkirch cedex

France
tél 03 88 67 14 14
fax 03 88 67 11 68
email vente@bioblock.fr
www.bioblock.com

Belgique / België
tél 056 260 260
fax 056 260 270
email belgium@bioblock.com
www.bioblock.be

España
tfno 91 515 92 34
fax 91 515 92 35
email ventas@bioblock.com
www.es.fishersci.com

Laboratoires ANIOS 05a-1200FR